

猪源胰蛋白酶残留检测试剂盒
（酶联免疫吸附法）
说明书

货号：1402422

版本：A/1

仅供研究用

湖州申科生物技术股份有限公司

■ 产品名称

通用名：猪源胰蛋白酶残留检测试剂盒（酶联免疫吸附法）。

■ 包装规格

96 测试/盒。

■ 预期用途

本试剂盒适用于生物制品下游纯化工艺中猪源胰蛋白酶（Trypsin）的定量测定。该试剂盒能识别市面上常见的重组猪胰蛋白酶以及胰蛋白酶（猪胰腺）。该试剂盒仅供研究使用，不可用于临床。


■ 检测原理

猪源胰蛋白酶（Trypsin）是一种丝氨酸蛋白酶，可特异切割赖氨酸及精氨酸 C 末端肽键。主要用于重组胰岛素的生产，激活病毒颗粒，疫苗生产工艺中细胞的处理等。本试剂盒基于固相酶联免疫吸附分析法（Enzyme-linked Immunosorbent Assay, ELISA），采用双抗体夹心的技术原理检测样品中 Trypsin 的残留量。该分析方法通过包被针对 Trypsin 的多克隆抗体来捕获样品中的残留 Trypsin，接着加入生物素标记的抗 Trypsin 抗体进一步孵育结合，随后加入 HRP（Horseradish Peroxidase，辣根过氧化物酶）标记的链霉亲和素，温育后洗涤；加入 TMB（3,3',5,5'-四甲基联苯胺）底物反应，HRP 催化 H_2O_2 氧化 TMB 生成蓝色产物（最大吸收峰 655 nm），随后加入终止液终止酶催化反应，生成黄色产物（最大吸收峰 450 nm）。酶标仪采集 450 nm 波长下吸光度值，其吸光度与校准品和样品中的 Trypsin 浓度成正相关。通过剂量-反应曲线可计算得出样品中 Trypsin 的浓度。

该方法对样品无需特殊处理，通过实际样品的适用性验证，在合适的稀释比例进行检测。本试剂盒检测快速，专一性强，性能稳定可靠。

 注：下文中 Trypsin 表示猪源胰蛋白酶。

检测原理示意图：

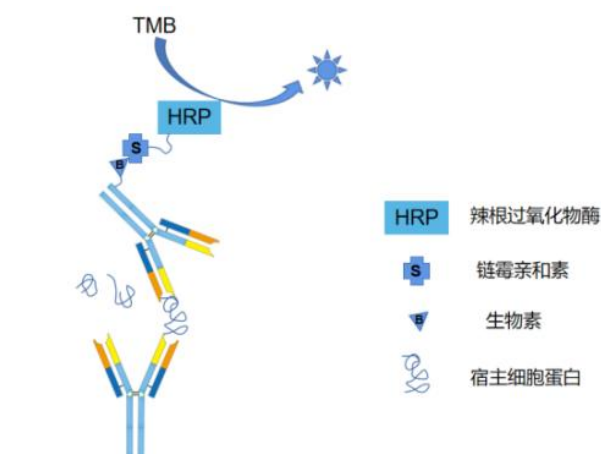

■ 主要组分

表 1. 试剂盒组分

组分	产品号	规格	说明
Trypsin 校准品	PNB006	2 管	含已赋值的 Trypsin 冻干制剂，具体含量见瓶身标注。
Trypsin 校准品复溶液	PNC003	240 μ L $\times$ 1 管	低盐酸溶液，操作时戴好护目镜并避免接触皮肤。
抗 Trypsin 预包被酶标板	PNA006	8 孔 $\times$ 12 条	已包被适量的绵羊抗 Trypsin 抗体，铝箔袋密封包装，含干燥剂。用后所余板条及时密封保存。
浓缩缓冲液 (10 $\times$)	PNF001	25 mL $\times$ 3 瓶	低温时易产生结晶，使用前可在 37 $^{\circ}$ C 水浴中溶解后用新鲜制备的超纯水稀释 10 倍，即为 1 $\times$ 缓冲液，用于洗板。
生物素偶联抗 Trypsin 抗体 (100 $\times$)	PNG006	140 μ L $\times$ 1 管	经生物素偶联的抗 Trypsin 的绵羊多抗，使用前用 1 $\times$ 缓冲液稀释 100 倍。
链霉亲和素 HRP 复合物 (100 $\times$)	PNH002	140 μ L $\times$ 1 管	HRP 偶联的链霉亲和素，使用前用 1 $\times$ 缓冲液稀释 100 倍。
TMB 显色液	PND002	12 mL $\times$ 1 瓶	使用前平衡于室温 20 min 以上，应避光并密封保存。
终止液	PNI002	6 mL $\times$ 1 瓶	高盐酸溶液，操作时戴好护目镜并避免接触皮肤。
封板膜	PNK001	3 片	用于检测过程中温育时间超过 30 min 时密封覆盖酶标板条，防止污染和液体蒸发。

■ 储存条件及有效期

1. 未开封试剂盒置 2-8 °C 保存，有效期为 12 个月。
2. 开封组分的保存要求如下：

表 2. 开封组分有效期

名 称	效 期
开封预包被酶标板	开封后的酶标板条连同干燥剂于铝箔袋中密封保存，在 2-8 °C 条件经验证可以稳定保存 90 天。
Trypsin 校准品	校准品经 Trypsin 校准品复溶液复溶后分装，可在 -18 °C 条件下可以稳定保存 90 天，最大冻融次数 3 次。

■ 实验所需但试剂盒中未含材料

- 稀释用的无菌离心管
- 拍干酶标板的吸水纸
- 加样槽

■ 相关设备

- 酶标仪能够检测 450 nm 吸光度值，如同时能再检测 620-650 nm 区间内任一波长的吸光度值更佳
- 恒温培养箱（25 °C ± 3 °C）
- 单道和多道的微量移液器
- 洗板机
- 微孔板恒温振荡器

■ 样品处理

1. 样品：纯化工艺过程样品，原液等。应清澈透明，经离心或过滤等方式去除不溶物。

2. 存放：样品务必事先有稳定性的研究，明确最佳的保存条件；一般建议样品长期储存应放置于 -65 °C 以下环境中，且不宜反复冻融。

3. 对初次使用或 Trypsin 含量未知的情况，强烈建议进行样品适用性验证，确定适宜的样品稀释倍数，以便更好进行后续常规检测。

4. 实验过程中建议加入贵司内控品或我司质控品保证实验有效性。我司质

控品可单独购买。

 相关验证方案可咨询我司技术支持。

■ 操作方法

1. 实验前准备

(1) 将 Trypsin 残留检测试剂盒从 2-8 °C 冰箱取出, 于室温平衡 20 min。

(2) 取出浓缩缓冲液 (10×), 溶液如有结晶是正常现象, 于 37 °C 温育直至完全溶解。

(3) 根据检测样品数量计算所需孔数, 平衡后从铝箔袋中取出相应数量的预包装酶标板条, 剩余板条连同干燥剂置于铝箔袋中密封, 放回试剂盒中, 保存在 2-8°C 冰箱, 请于效期内使用完。

 室温指 25 °C ± 3 °C, 下同。若实验室室温波动大, 孵育时建议放置恒温箱内。

2. 试剂配制

2.1 Trypsin 校准品溶解

校准品原液配置, 取出 Trypsin 校准品用微型离心机进行离心, 精确量取 100 μL 校准品复溶液于可立冻存管中, 用涡旋振荡器和微型离心机, 振荡离心 3 次, 复溶后校准品溶液按照推荐保存方法于效期内使用。

2.2 1×缓冲液配制

浓缩缓冲液 (10×) 用超纯水稀释 10 倍, 例如取 25 mL 浓缩缓冲液 (10×) 加入 225 mL 超纯水混匀, 即为 1×缓冲液, 建议现配现用。

2.3 校准曲线配制

参照表 3 对校准品进行梯度稀释。

表 3. 系列校准品梯度稀释

校准曲线样品	加样	浓度(ng/mL)
ST1	将校准品原液用 1×缓冲液稀释到 ST1 浓度	2.56
ST2	500 μL ST1 溶液+500 μL 1×缓冲液	1.28
ST3	500 μL ST2 溶液+500 μL 1×缓冲液	0.64
ST4	500 μL ST3 溶液+500 μL 1×缓冲液	0.32
ST5	500 μL ST4 溶液+500 μL 1×缓冲液	0.16
ST6	500 μL ST5 溶液+500 μL 1×缓冲液	0.08
ST7	500 μL ST6 溶液+500 μL 1×缓冲液	0.04
NCS (阴性对照)	1×缓冲液	0

 建议先将校准品原液稀释 10 倍，即 10 μL 校准品原液加入到 90 μL 1×缓冲液中混匀。用 10 倍稀释后的校准品配制 ST1。

2.4 样品处理

待测样品根据其预估所含的 Trypsin 浓度，用 1×缓冲液稀释适当倍数，使其检测值落入标曲定量范围之内。

3. 标准操作步骤

3.1 加样孵育

(1) 单通道移液器配合吸头准确移取 100 μL 系列校准品溶液及 1×缓冲液 (NCS) 加入相应微孔板中，溶液加入孔底部，操作时避免产生气泡，每个浓度做 3 个平行复孔，并记录各浓度孔所在位置。

(2) 将处理好的待测样品按同样操作加入相应微孔板中。加样后将微孔板用封板膜密封，放置于微孔板恒温振荡器上，室温，转速 500 rpm，避光孵育 1 h。

(3) 实际检测时可根据样品数量，参照下表 4 示例进行 96 孔板排版加样。

表 4.96 孔酶标板加样排版示例

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	ST1	ST1	ST1		S1	S1	S1					
B	ST2	ST2	ST2		S2	S2	S2					
C	ST3	ST3	ST3		S3	S3	S3					
D	ST4	ST4	ST4		S1+SR C	S1+SR C	S1+SR C					
E	ST5	ST5	ST5		S2+SR C	S2+SR C	S2+SR C					
F	ST6	ST6	ST6		S3+SR C	S3+SR C	S3+SR C					
G	ST7	ST7	ST7									
H	NCS	NCS	NCS									

✧ 该示例表示的是检测 7 个浓度梯度的校准曲线 (ST1-ST7)、1 个阴性对照 NCS、3 个待测样品 (S1-S3) 和每个样品加标回收 SRC (S1 SRC-S3 SRC)。每个检测做 3 个重复孔。

3.2 1×生物素偶联抗 Trypsin 抗体孵育

3.2.1 抗体配制

用 1×缓冲液于无菌离心管中将生物素偶联抗 Trypsin 抗体 (100×) 稀释 100 倍, 轻轻颠倒混匀 10 次, 即为 1×生物素偶联抗 Trypsin 抗体。配制合适体积, 以保证加液时有充足的余量。

3.2.2 洗涤

倒去微孔板内反应液, 用 1×缓冲液洗板, 洗板机参数设定: 340 μL/孔, 浸泡振荡 15 s, 吸干, 此步骤循环 3 次, 机洗结束后, 迅速甩掉液体, 于纸巾上拍干。

 洗板后的微孔板应立即进行后续操作, 不可过久放置, 避免微孔板干燥导致抗体活性下降。

3.2.3 孵育

取 1×生物素偶联抗 Trypsin 抗体溶液倒入加样槽中, 用多通道移液器配合吸头快速将抗体溶液 100 μL/孔加入上述微孔板孔底部, 勿引入气泡。封板膜密封后, 于室温避光反应 45 min。

3.3 链霉亲和素 HRP 复合物孵育

3.3.1 复合物溶液配制

用 1×缓冲液将链霉亲和素 HRP 复合物(100×)稀释 100 倍, 轻轻颠倒混匀 10 次, 即为 1×链霉亲和素 HRP 复合物溶液。配制合适体积, 以保证加液时有充足的余量。

3.3.2 洗涤

将上述微孔板用 1×缓冲液洗板 3 次, 于纸巾上拍干后, 立即进行以下操作, 避免干燥。

3.3.3 孵育

取 1×链霉亲和素 HRP 复合物溶液倒入加样槽中, 用多通道移液器配合无菌吸头快速将溶液 100 μ L/孔加入上述微孔板孔底部, 勿引入气泡。封板膜密封后, 于室温避光反应 30 min。

3.4 显色

(1) 将上述板子用 1×缓冲液洗板 5 次, 于纸巾上拍干后, 立即进行以下操作, 避免干燥。

(2) 取合适体积的 TMB 显色液于加样槽中, 用多通道移液器迅速将 TMB 显色液 100 μ L/孔加入上述微孔板中, 于室温避光反应 15 min。此步骤勿用封板膜密封。

3.5 终止

取合适体积的终止液于加样槽中, 用多通道移液器迅速将终止液 50 μ L/孔加入上述微孔板中, 加入顺序需同显色液加入顺序一致, 加样时吸头应悬空, 避免接触微孔板中溶液, 切勿产生气泡。终止后的微孔板于室温避光放置 5 min。

3.6 测读

设定酶标仪波长 450 nm 和 620-650 nm(620-650 nm 区间内单一长波长均可), 测定各孔 OD 值。测定时不可覆盖封板膜或盖子。

 若酶标仪没有配备长波长时, 可以仅设定 450 nm 波长, 但是需确保微孔板孔底干净, 无指纹或刮痕

4. 结果计算

(1) 各孔 OD_{450 nm} 数值需减去各自孔的长波长 OD 值。若酶标仪没有配备长波长时, 可以省去此步骤。

(2) 各校准点的 OD 值减去 NCS (1×缓冲液对应的 OD_{450 nm} 均值) 的 OD 值后, 将 3 个重复孔取均值, 以浓度值和 OD 值进行四参数拟合, 获得校准曲线方程。将样品的平均 OD 值带入方程计算得到样品浓度。该浓度需乘以稀释倍数得到样品的实际浓度。

(3) 标曲的拟合软件可以用酶标仪自带的软件。如无, 则建议采用专业的标曲制作软件, 如 curve expert, ELISA Calc 等。

■ 检测结果的判断


对于吸光度值超出校准品 ST1 的样品, 可用 1×缓冲液稀释适宜倍数后再行测定, 样品中 Trypsin 浓度值为稀释后测定值×稀释倍数。同时设置在该稀释度下的适宜加标样品, 回收率符合相应法规的方法学验证要求。

■ 检测方法的局限性

1. 本品仅适用于研究用途, 不用于临床诊断。
2. 本品仅适用于 Trypsin (猪源胰蛋白酶) 残留检测。
3. 样品 pH 应保证在 6.0-8.0 之间, 过低或过高的 pH 可能会造成测量值异常。

■ 产品性能指标

1. 校准曲线拟合范围: 0.040-2.56 ng/mL, 线性相关系数 $R^2 \geq 0.990$ 。
2. 最低定量限 LLOQ: 0.040 ng/mL。
3. 典型校准曲线如下图:

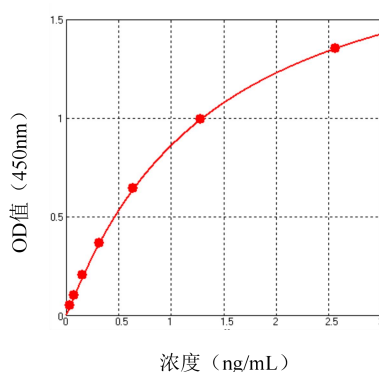

4. 精密性: 板内变异系数不高于 15%, 板间变异系数不高于 20%。
5. 特异性: 与宿主残留蛋白 (CHO、E.coli BL21、293T、Vero、汉逊酵母、MDCK) 无交叉反应。与人胰蛋白酶和牛胰蛋白酶的交叉反应率小于 0.01%。

❖ 快速操作流程



■ 重要事项提醒

试剂盒的使用人员需经过培训,合格后方可使用。为了获得满意的检测结果,请您务必事先留意如下几点事项:

1. 对初次使用或 Trypsin 含量未知的情况,强烈建议进行样品适用性验证,确定适宜的样品稀释倍数,以便更好进行后续常规检测。
2. 所有的试剂配制务必使用一次性的吸头、试管和加样槽等,充分混匀。避免微量移液器与吸头连接部分的污染,建议每次实验前后用 75%酒精擦拭移液器。规范移液操作,严禁液体倒吸至移液器中,或未去掉吸头时横放在试验台上。
3. 校准品和样品的稀释混匀要轻柔充分,勿产生大量泡沫。
4. 终止液为酸性溶液,在使用中注意眼睛、面部、手和衣服的防护。
5. 不同批次试剂盒不建议混用。
6. 配制缓冲液所用水需为无菌水或新鲜制备的超纯水,水温不得超过 37 °C。
7. 加样时将样品加于酶标板底部,尽量不接触孔壁。注意不要有气泡,可轻轻晃动混匀。在上机检测前若有气泡存在,需用干净的 10 μ L 吸头或针头等戳破,注意不要吸走孔内液体,导致结果误差大。
8. 在孵育反应时需给酶标板覆膜,防止样品蒸发。
9. 倒去缓冲液后应马上加后续溶液,勿让酶标孔处于干燥状态,以防影响试剂盒检测性能。
10. 未使用的酶标板条需用试剂盒附带的自封铝箔袋避光保存,以免被其他样品污染,导致试剂盒报废。
11. 校准品配制、样品稀释等务必精确,配制时最小的取样量不要小于 5 μ L,防止结果出现较大的误差。
12. 生物素偶联抗 Trypsin 抗体(100 $\times$)和链霉亲和素 HRP 复合物(100 $\times$)试剂请在用前进行快速离心,将管盖中残留的试剂甩到管底,防止试剂的污染和损失。
13. 已稀释到工作浓度的校准品、生物素偶联抗 Trypsin 抗体、链霉亲和素 HRP 复合物等因无法保证其稳定性,不建议再次重复使用。
14. 显色液应是无色透明液体。吸取时务必更换干净的吸头,防止 HRP 污染。如发现已有淡蓝色,请弃用。
15. 终止 5 min 后再上机检测,结果更稳定。

16. 由于叠氮钠能抑制 HRP 活性，对检测结果有很大影响，因此样品中不能添加叠氮钠。

17. 推荐使用多孔道洗板机进行洗板，无洗板机可进行手工洗板。

■ 常见问题分析

若实验结果出现异常，请及时对未使用的酶标板和试剂进行妥善保管，对显色的酶标板实验结果拍照，保留实验原始数据。联系我司技术支持为您解决问题。

以下常见的异常现象及解决方法供您参考：

问题描述	可能原因	解决方法
背景信号高：样品稀释液对应 OD450 值超过 0.150	1. 稀释所用的水污染； 2. 配液所用移液器、吸头、离心管等耗材污染； 3. 操作环境不洁净； 4. Trypsin 校准品稀释过程中造成污染； 5. 洗板操作不规范； 6. 洗板次数不够，加液量不足，浸泡时间不足； 7. 试剂错配。	1. 使用无菌或新制备的超纯水稀释缓冲液； 2. 移液器应专用，并使用无菌带滤芯吸头； 3. 试验操作分区； 4. 校准品稀释操作应规范，瓶（管）口切勿触碰移液器外壁，造成管间交叉污染； 5. 手动洗板时移液器吸头应悬空，切勿触及管内液面； 6. 严格按照说明书推荐的加液量、洗板次数和浸泡时间，切勿随意更改； 7. 生物素偶联抗 Trypsin 抗体（100×）或者链霉亲和素 HRP 复合物(100×)使用时未稀释 100 倍或稀释错误。
读数后某些孔 OD 值异常偏高	1. 手动洗板过程中，甩液不迅速，或反复多次甩板，造成孔间液体飞溅交叉污染； 2. 手动洗板后，纸巾上拍干时操作不当或未更换新纸巾； 3. 加样操作不当； 4. 温育时未覆盖封板膜； 5. 揭开封板膜时操作不当，导致孔内液体飞溅。	1. 手动洗板时，甩液应一次完成，快速彻底； 2. 板子拍干用的纸巾是一次性用品，不得重复使用。在纸巾上拍干时，每拍一次更换一个新位置或新纸张，勿使拍痕重叠，若残留液体造成纸巾湿透，应弃去旧纸巾，重新铺就多层纸巾，每洗板一次拍干 4~5 次为宜； 3. 加样应匀速加于微孔板孔底部，防止加在孔壁上缘，飞溅造成邻近孔污染； 4. 微孔板孵育时应覆盖封板膜防止液体蒸发和污染杂物； 5. 揭开封板膜时，将微孔板平放在水平桌面上，用一只手的拇指和食指紧紧压在板子两侧防止移动，另一只手从一个角开始匀速揭开封板膜，过程中要始终保持板子不离开桌面，防止孔内液体飞溅。

【参考文献】

- 1、YY/T 1183-2010 酶联免疫吸附法检测试剂（盒）。
- 2、中国药典（2020）生物制品通则《生物制品生产用原材料及辅料质量控制》。

生效日期：2023 年 01 月 09 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址：浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话：0572-2165910